

Số: 253/TTYTTT-LKD

Tiên Lãng, ngày 19 tháng 6 năm 2025

“V/v chào giá đối với dịch vụ sửa chữa, thay thế màn LCD của máy nội soi dạ dày EPX 2200”

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Áp dụng đối với gói thầu Sửa chữa, thay thế màn hình LCD của máy nội soi dạ dày EPX 2200 của Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng.**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, thay thế màn hình LCD của máy nội soi dạ dày EPX 2200 của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

#### **1. Đơn vị yêu cầu báo giá:**

- Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng
- Địa chỉ: Số 130 Phạm Ngọc Đa, Khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;

#### **2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Yến, chức vụ: Trưởng khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế.

- Số điện thoại: 0369.320.978

- Địa chỉ email: [Yen081282@gmail.com](mailto:Yen081282@gmail.com)

#### **3. Cách thức nhận báo giá: Theo địa chỉ nhận trực tiếp:**

Nguyễn Thị Yến, chức vụ: trưởng khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế; Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng.

Địa chỉ: Số 130 Phạm Ngọc Đa, Khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;

Số điện thoại: 0369.320.978

**4. Thời gian nhận báo giá:** Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin thành công trên trang Website của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng.



Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

## **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

### **1. Danh mục hàng hóa sửa chữa bao gồm:**

| Stt | Danh mục                           | Nội dung (dự đoán sơ bộ)              | Số lượng | Đơn vị tính |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|
| 1   | Màn hình SONY<br>Model: LMD-1530MD | Hỏng: Bật không lên, màn hình tối đen | 01       | Máy         |
|     | <b>Tổng khoản: 01</b>              |                                       |          |             |

**2. Địa điểm cung cấp:** Khoa Dược – trang thiết bị - vật tư y tế; Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng. Địa chỉ: Số 130 Phạm Ngọc Đa, Khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng;


**3. Thời gian dự kiến thực hiện:** Trong vòng 05 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

### **4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:**

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán thuộc trách nhiệm của nhà thầu theo quy định của pháp luật.

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

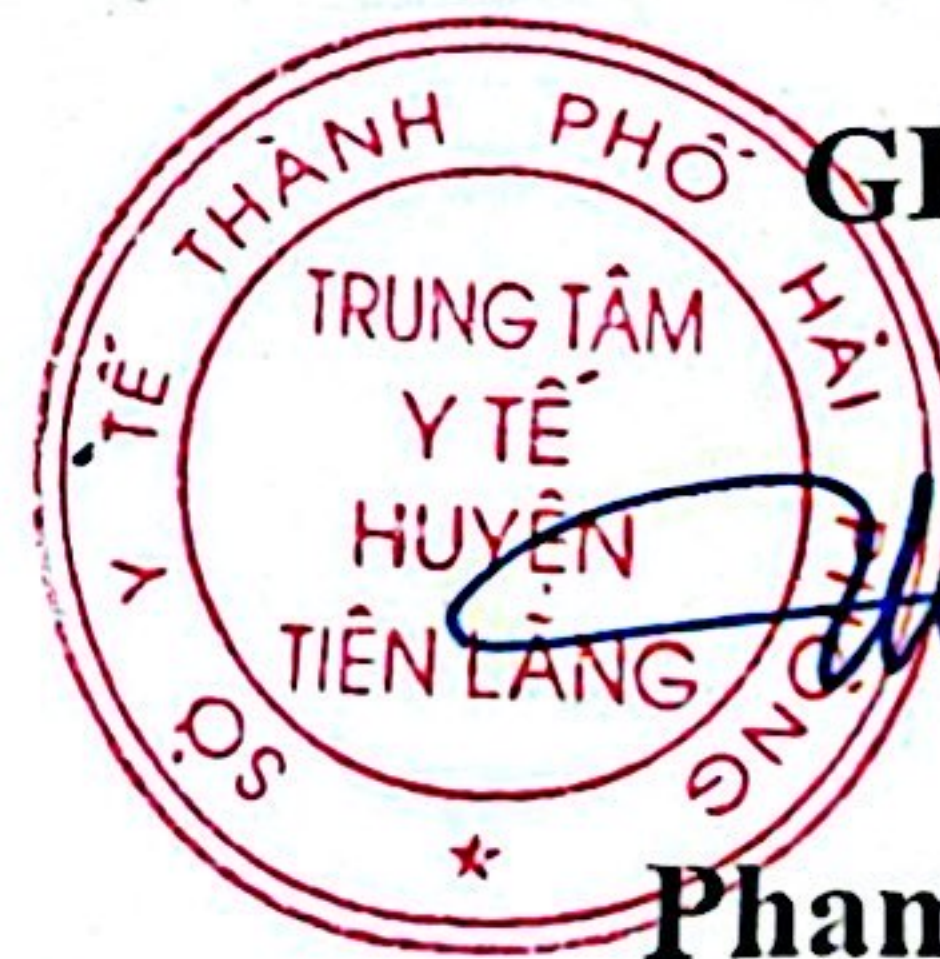

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Tiến Thành**